


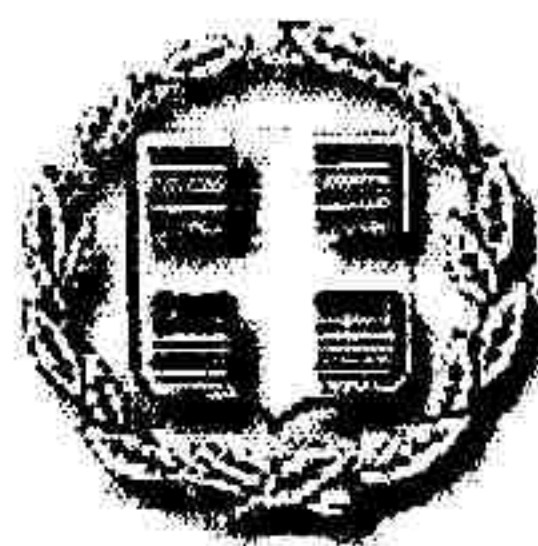

26 ΙΑΝ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24/7/2013.

Αρ. Πρωτ.: 63142

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 12197/25-6-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Χ.-Μ. Γιαταγάνα, σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος Λιθοτριψίας στο Νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το μηχάνημα εξωσωματικής λιθοτριψίας που είναι εγκαταστημένο στο συγκρότημα «Παναγία» του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος είναι τύπου sonolith 4000 της Γαλλικής εταιρίας Technomed International. Εγκαταστάθηκε στο «ΠΑΝΑΓΙΑ» το Μάρτιο του 1994 από την εταιρεία Ηλεκτράθα Φαίδων Αθανασούλας & Σια ΕΠΕ, βάσει σύμβασης που είχε υπογράψει η τελευταία με το ΙΚΑ.

Το εν λόγω μηχάνημα, το οποίο είναι εκτός λειτουργίας από τις 8-3-2013, παρουσιάζει πολλαπλές βλάβες. Η προμηθεύτρια εταιρεία, μετά από επανειλημμένες επισκέψεις τεχνικών της, πιθανολογεί ότι απαιτείται αντικατάσταση της γεννήτριας, δαπάνης 50.000 €.

Το Νοσοκομείο, με το αρ. 9001/10-5-2013 έγγραφό, του υπέβαλε αίτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια της γεννήτριας και την επισκευή του Λιθοτρίπτη. Η τελευταία προκειμένου να εγκρίνει τη διαδικασία, ζήτησε βεβαίωση της προμηθεύτριας εταιρείας ότι μετά την αντικατάσταση της γεννήτριας το μηχάνημα θα λειτουργεί.

Ύστερα από διάφορες προφάσεις και καθυστερήσεις η προμηθεύτρια εταιρεία απέστειλε τελικά στις 16/7/2013 τεχνικό από τον κατασκευαστικό οίκο της Γαλλίας και αναμένεται η τελική τεχνική έκθεση και η βεβαίωση που ζητά η Ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να εγκρίνει την αντικατάσταση της γεννήτριας και την επισκευή του Λιθοτρίπτη.

Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας έχει υποβληθεί αίτημα από την 4^η ΥΠΕ για προμήθεια ενός Συγκροτήματος Λιθοτριψίας για τις ανάγκες του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», δαπάνης 700.000,00 €.

Η ικανοποίηση του αιτήματος θα εξεταστεί στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Υπουργείου.

Όσον αφορά την προμήθεια του μηχανήματος Λιθοτριψίας στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», σύμφωνα με το αρ. 27102/17-6-2013 έγγραφο του Νοσοκομείου, κλήθηκε η εταιρία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ προκειμένου να παραλάβει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση υπογράφηκε στις 11-7-2013.

Ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, ορίζεται στις 30 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ωστόσο η

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:-

Σύνολο σελίδων: 2

προμηθεύτρια εταιρία, με το από 15-7-2013 έγγραφό της, αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 30-10-2013.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Χ.-Μ. Γιαταγάνα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 5.Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

