


06 ΑΥΓ. 2014

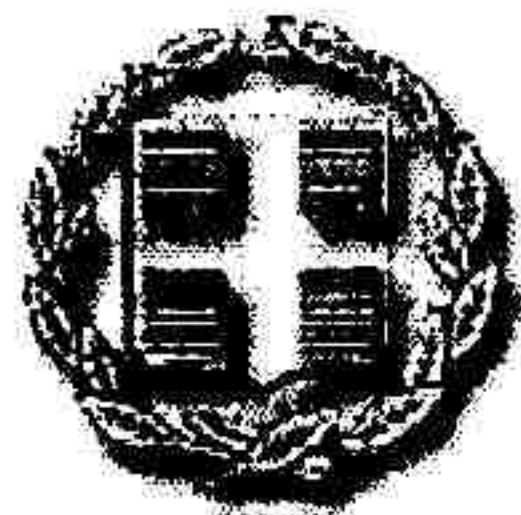

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4/8/14

Αρ. Πρωτ.: 54117

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 156/18-6-2014 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη, σχετικά με τη λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστώσεων στους σχετικούς ΚΑΕ Φ200, του προϋπολογισμού Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη έτους 2014, δεν κατέστη δυνατή η άμεση επισκευή του εν λόγω μηχανήματος.

Το ΓΝ Τρικάλων έχει προβεί στη σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού, στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τροποποίησης, το Νοσοκομείο θα προβεί άμεσα στην επισκευή του μηχανήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου,
Θ. Κωνσταντινίδη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Υφυπουργών
- 3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου, Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

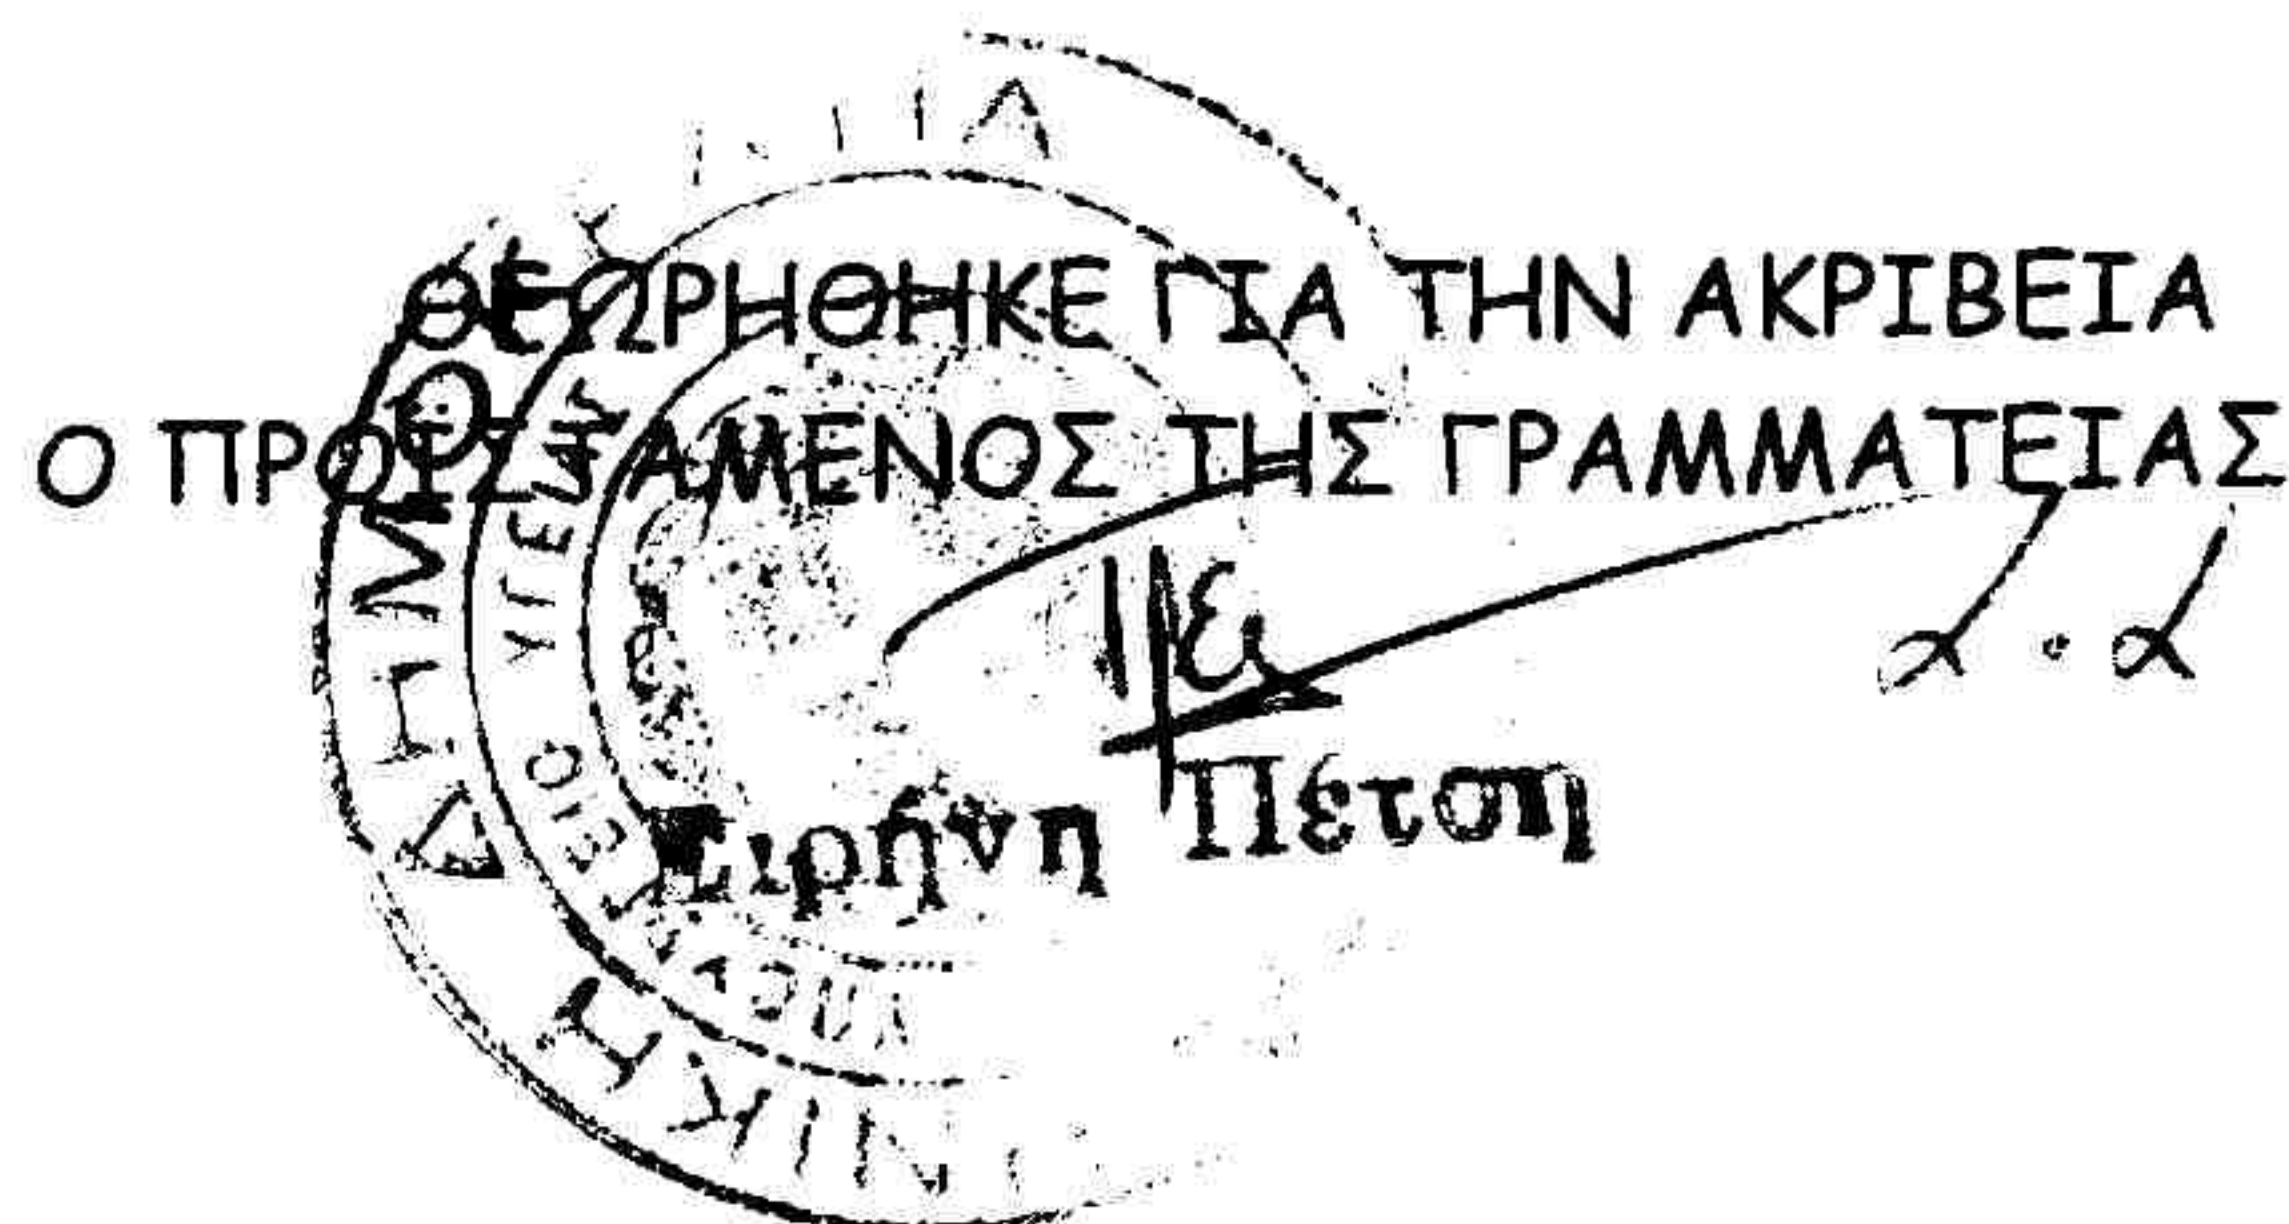

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1