


05 ΑΥΓ. 2015

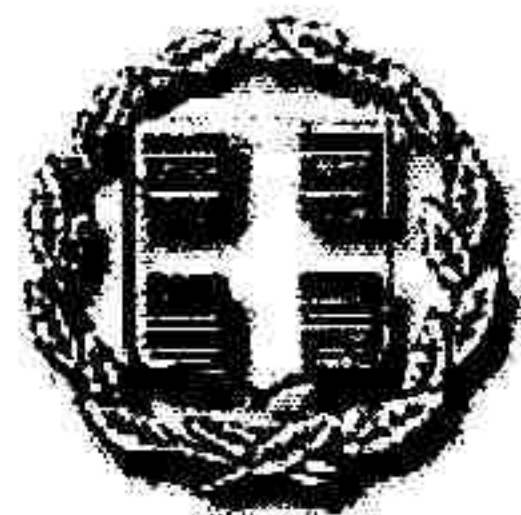

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4 / 8 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 43787

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428
Fax : 2105237254
e-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 3310/8-6-2015 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Βουλευτή κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου, με θέμα: «Υπό την συνεχή ταλαιπωρία μετακινήσεων οι καρκινοπαθείς της Θεσσαλίας ελλείπει κατάλληλου ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της περιφέρειας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από την καταγραφή ι/τα εξοπλισμού υψηλού κόστους/τεχνολογίας αιχμής που έχει πραγματοποιήσει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας (τελευταία επικαιροποίηση 10^{ος} /2014) προκύπτει ότι, στο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Π.Γ.Ν. Λάρισας είναι εγκατεστημένοι από το έτος 1998 δύο (2) Γραμμικοί Επιταχυντές του κατασκευαστικού οίκου PHILIPS σε «ΚΑΛΗ» λειτουργική κατάσταση και ένας (1) Εξομοιωτής Ακτινοθεραπείας του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το ίδιο έτος εγκατάστασης σε «ΜΕΤΡΙΑ» λειτουργική κατάσταση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωμοδότησε με τα ΔΥ8δ/31-8-2012 και ΔΥ8δ/ΓΠ/12-6-2013 Υπηρεσιακά Σημειώματα προς την Δ.Α.Μ.Υ. για την προμήθεια ενός (1) Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας και ενός (1) Γραμμικού Επιταχυντή και στη συνέχεια έχουν εκδοθεί οι Υ4β/ΓΠ 66567/Φ8γ2-126/01-11-2012 και Υ4β/ΓΠ 51959/17-07-2013 Αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της ΔΑΜΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κ. Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

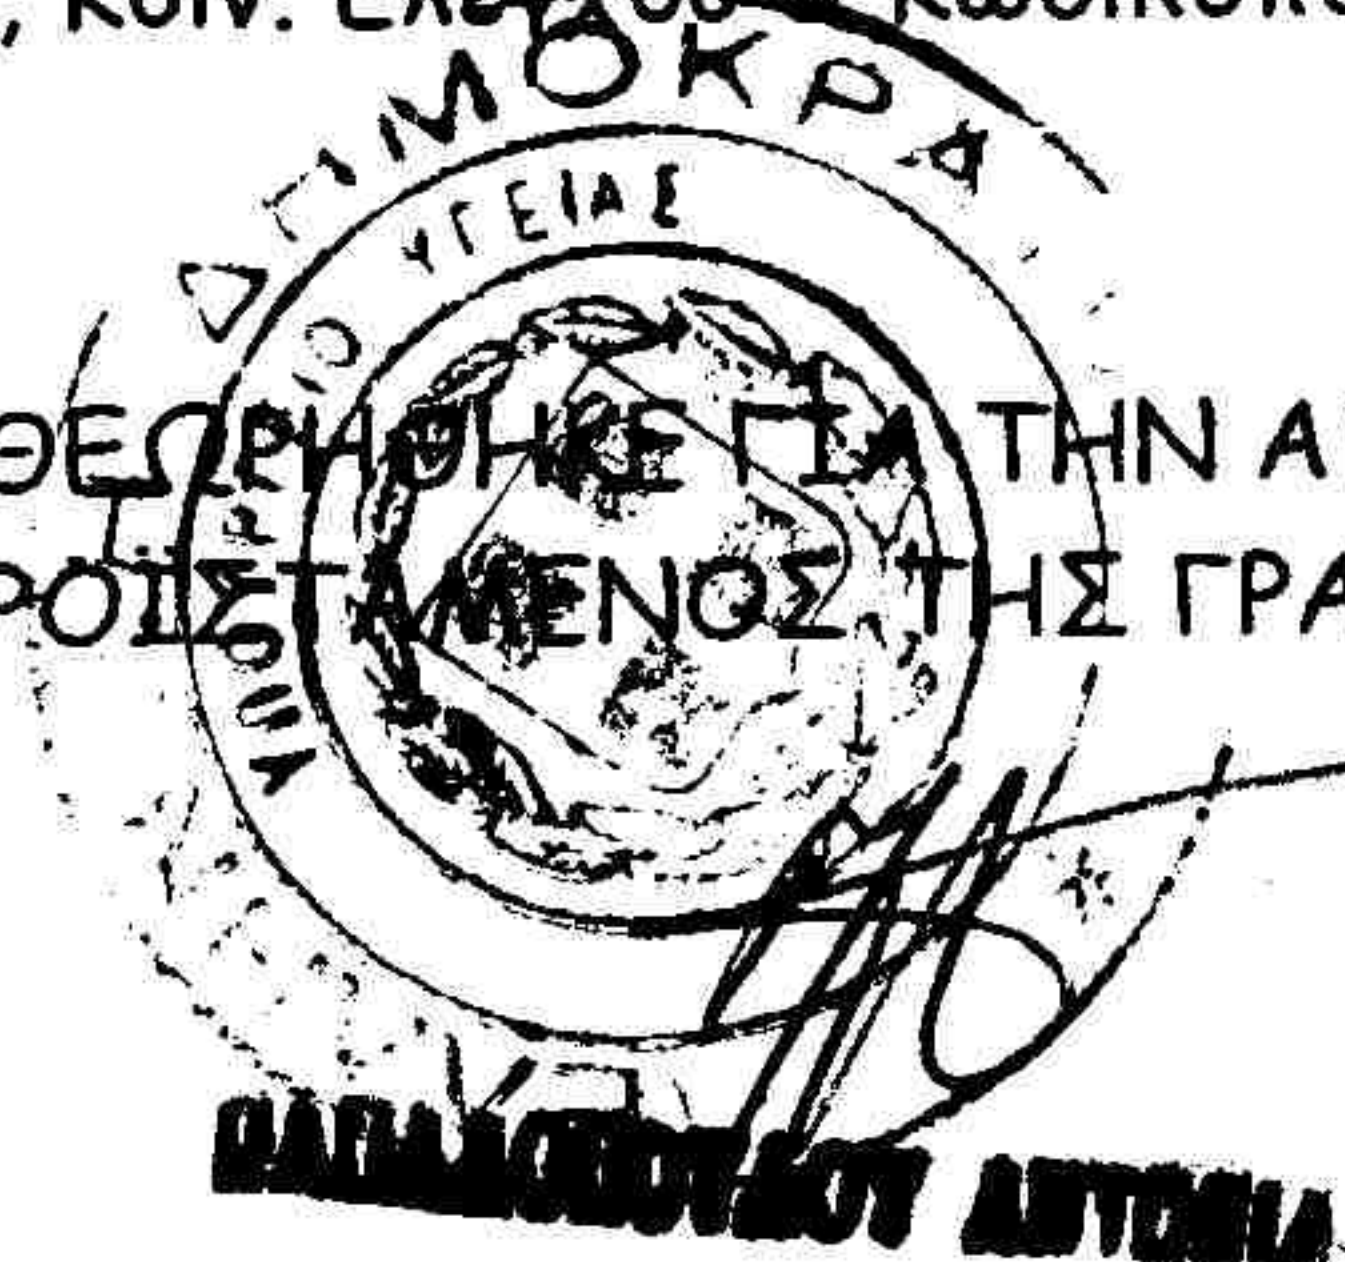

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 1