



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410, 2103707420

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ


Για τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι βουλευτές: Σταύρος Σκοπελίτης, Νίκος Παπακωνσταντίνου και Γιώργος Μαυρίκος.

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ν. Σάμου, με την οποία καταγγέλλει ότι εδώ και πάνω από ένα μήνα δεν λειτουργούν ο αξονικός τομογράφος και το ακτινολογικό μηχάνημα στο Νοσοκομείο Σάμου.

Αθήνα

Οι καταθέτοντες βουλευτές

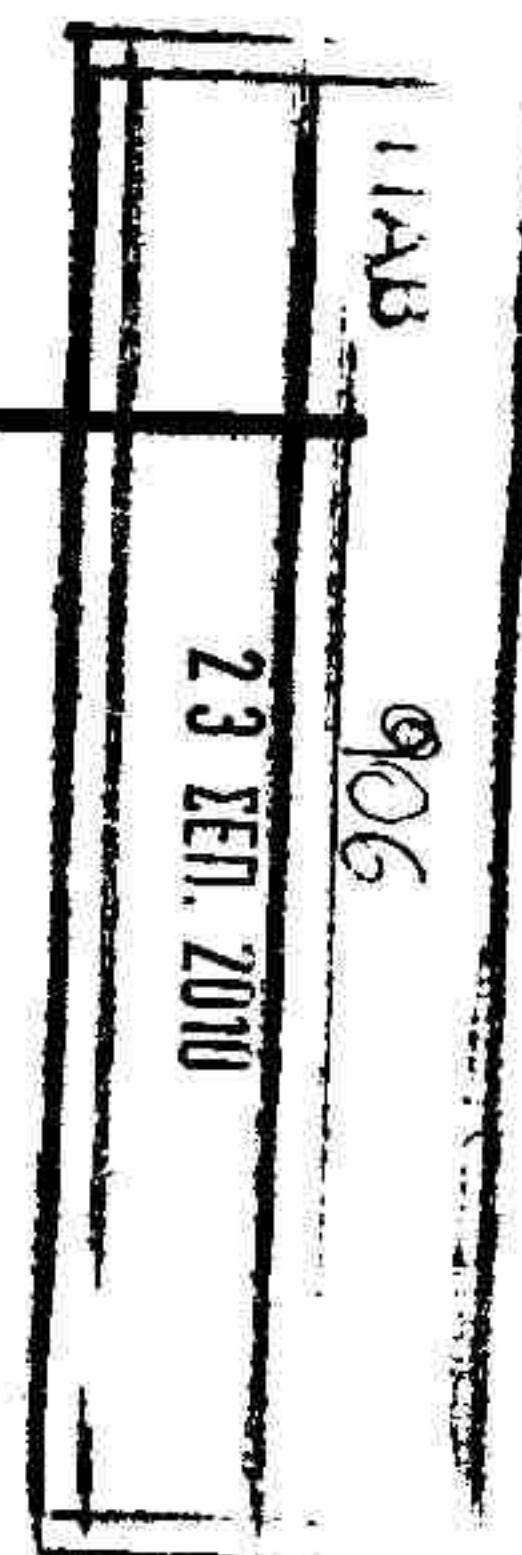

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ Γ.Σ.Ε.Ε. - ΣΜΥΡΝΗΣ 2 - 83100 ΣΑΜΟΣ

ΤΗΛ. 2273 027561 - FAX 2273 028440

E-mail : eksamou@otenet.gr

Σάμος 15 Σεπτέμβρη 2010

Αριθ. Πρωτ. 353

Προς : Υπουργό Υγείας
Κοιν : 1) Κόμματα Βουλής
2) Βουλευτή Σάμου
3) Νοσοκομείο Σάμου
4) Σύλ. Εργαζομένων Νοσοκομείου
5) ΜΜΕ

Εδώ και πάνω από έναν μήνα στο Νοσοκομείο Σάμου δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος καθώς και το ακτινολογικό μηχάνημα.

Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς (του Νομού αλλά και άλλων νησιών που καλύπτει το νοσοκομείο Σάμου) που έχουν την ανάγκη αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων να απευθύνονται σε ιδιωτικά διαγνωστήρια πληρώνοντας οι ίδιοι τις πανάκριβες εξετάσεις.


Η κατάσταση αυτή να μην φτιάχνονται τα μηχανήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι απαράδεκτη και προφανώς εντάσσεται στην κυβερνητική πολιτική σας τόσο για δραστική μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία όσο και για την εξασφάλιση ακόμα μεγαλύτερων κερδών στους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας.

Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα πληρώνουμε και με το παραπάνω τις εισφορές που απαιτούνται για να έχουμε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε ζητήματα υγείας και απαιτούμε την άμεση λύση του προβλήματος (είτε να επιδιορθωθούν τα μηχανήματα αν φτιάχνονται είτε να αγορασθούν νέα).

Για την Διοίκηση

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Δράκος

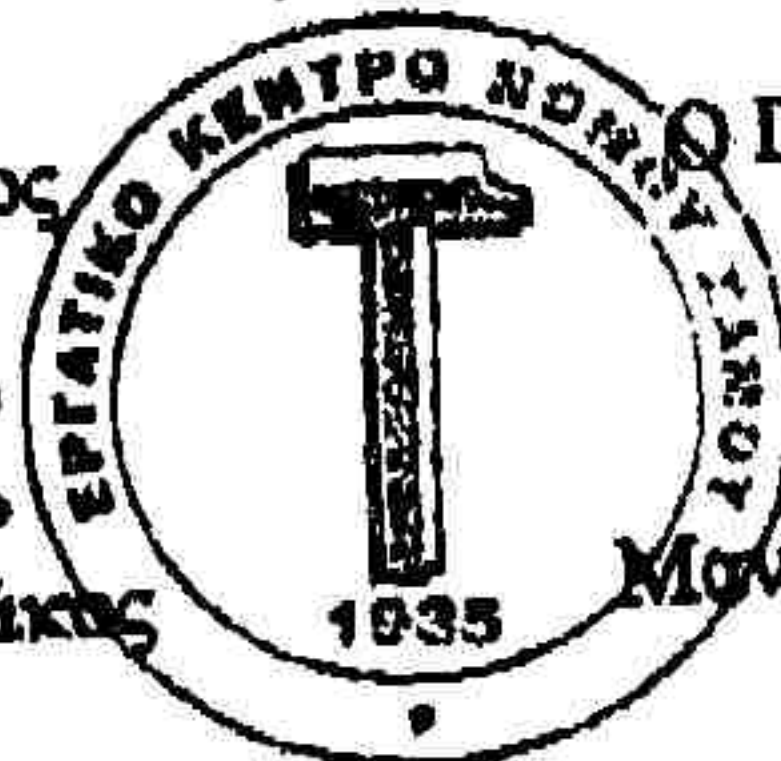

Ο Γεν. Γραμματέας

Μανώλης Νεοφώτιστος