


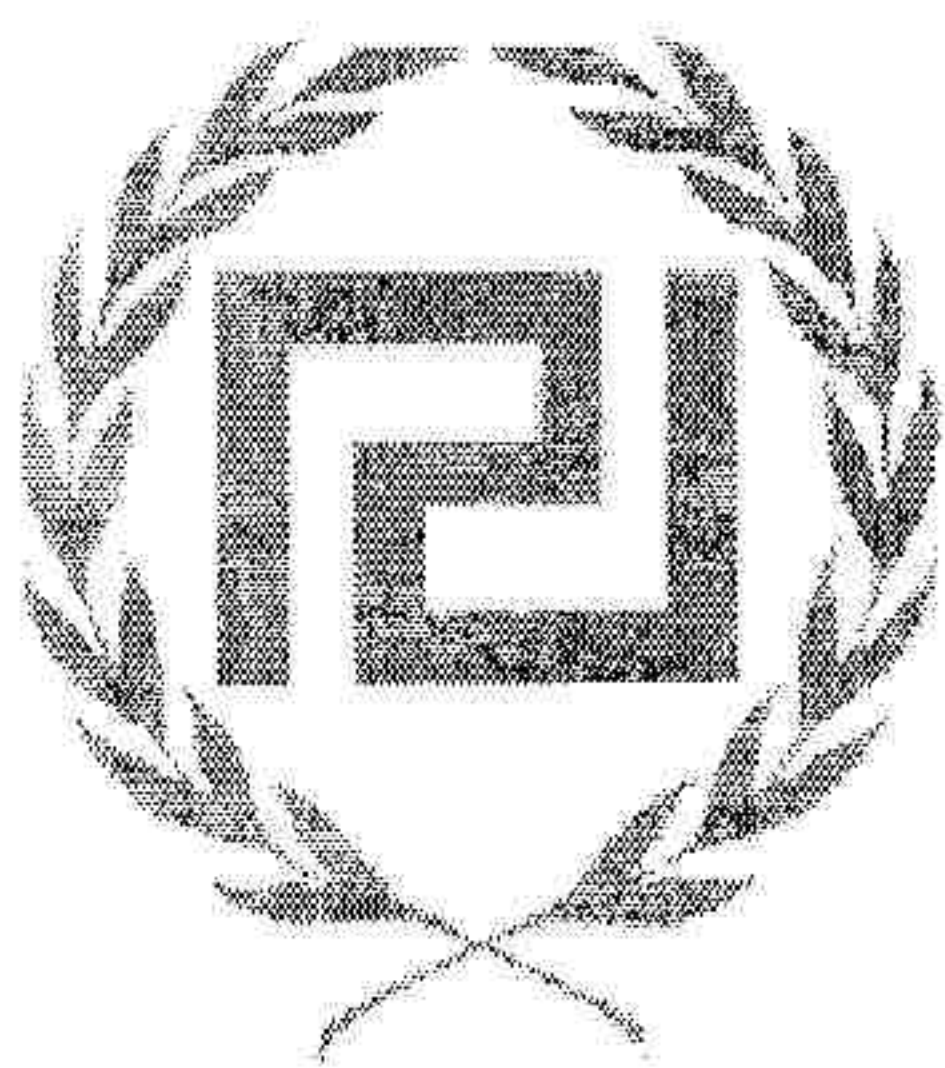

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

1606
6.4.15

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
Βουλευτής ΚΙΛΚΙΣ

Πολιτικό Γραφείο: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2103707960, 7963


ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Μεγάλες οι ελλείψεις στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λέρου»

Το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Λέρου παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τις βροχές τα νερά εισχωρούν στο εσωτερικό του. Εκτός όμως τούτου, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με την συντήρηση των ακτινολογικών μηχανημάτων τα οποία διαθέτει. Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να δέχονται μεγαλύτερες δόσεις ραδιενέργειας ανά ακτινογραφία αλλά και η ευκρίνεια των ακτινογραφιών να μην είναι πάντα επαρκής. Μάλιστα οι αρμόδιοι του νοσοκομείου της Λέρου δήλωσαν ότι η κατάσταση είναι τόσο πιεστική ώστε εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα είναι αναγκασμένοι να κλείσουν άμεσα το ακτινολογικό τμήμα. Ακόμη και τηλεϊατρική να υπήρχε, όπως ανέφεραν, για την ανάγνωση των ακτινογραφιών από απόσταση, πρέπει

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958

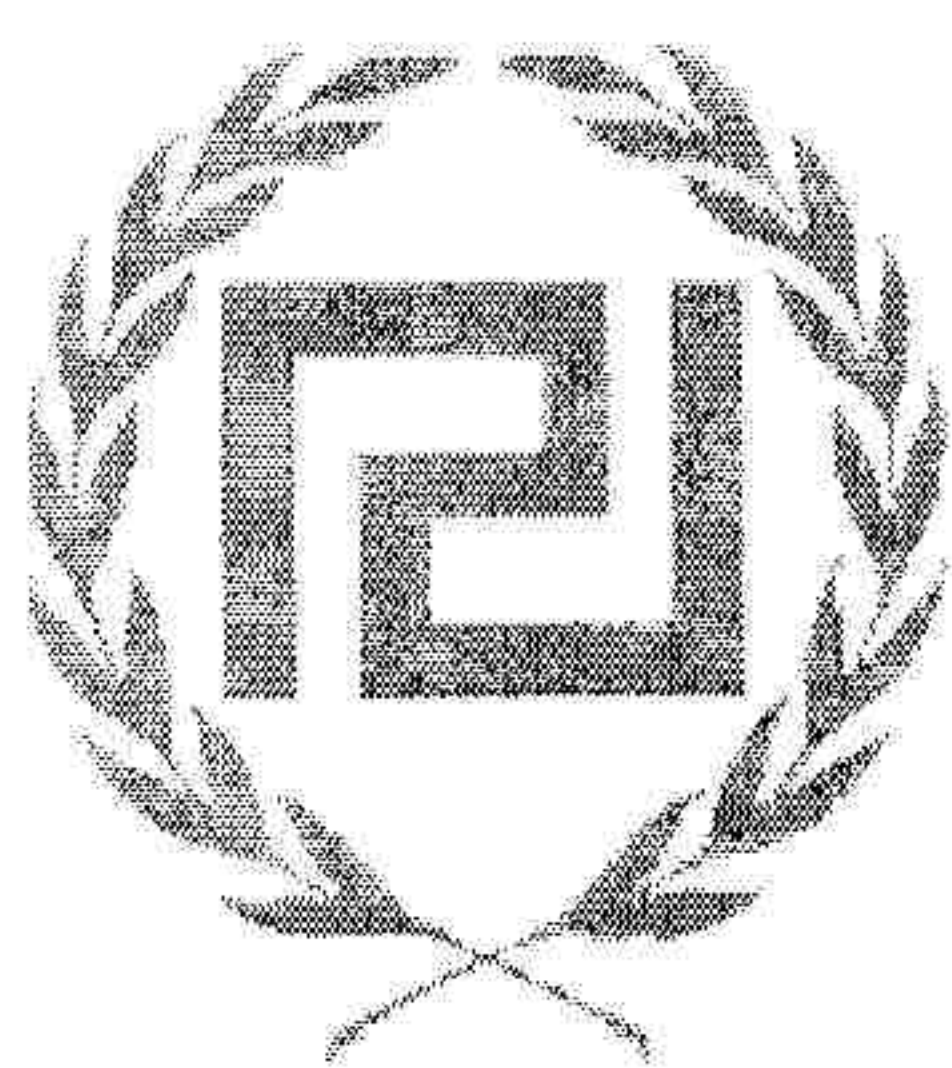

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

οπωσδήποτε οι ακτινογραφίες να τυπώνονται σωστά από άψογα συντηρημένα μηχανήματα.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- 1) Ποια μέτρα πρόκειται να λάβετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα της συντήρησης των ακτινολογικών μηχανημάτων;
- 2) Ποια μέτρα πρόκειται να λάβετε ώστε να συντηρηθούν οι χώροι που στεγάζεται το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λέρου;

Αθήνα, 06/04/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Χατζησάββας

Βουλευτής Κιλκίς

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958